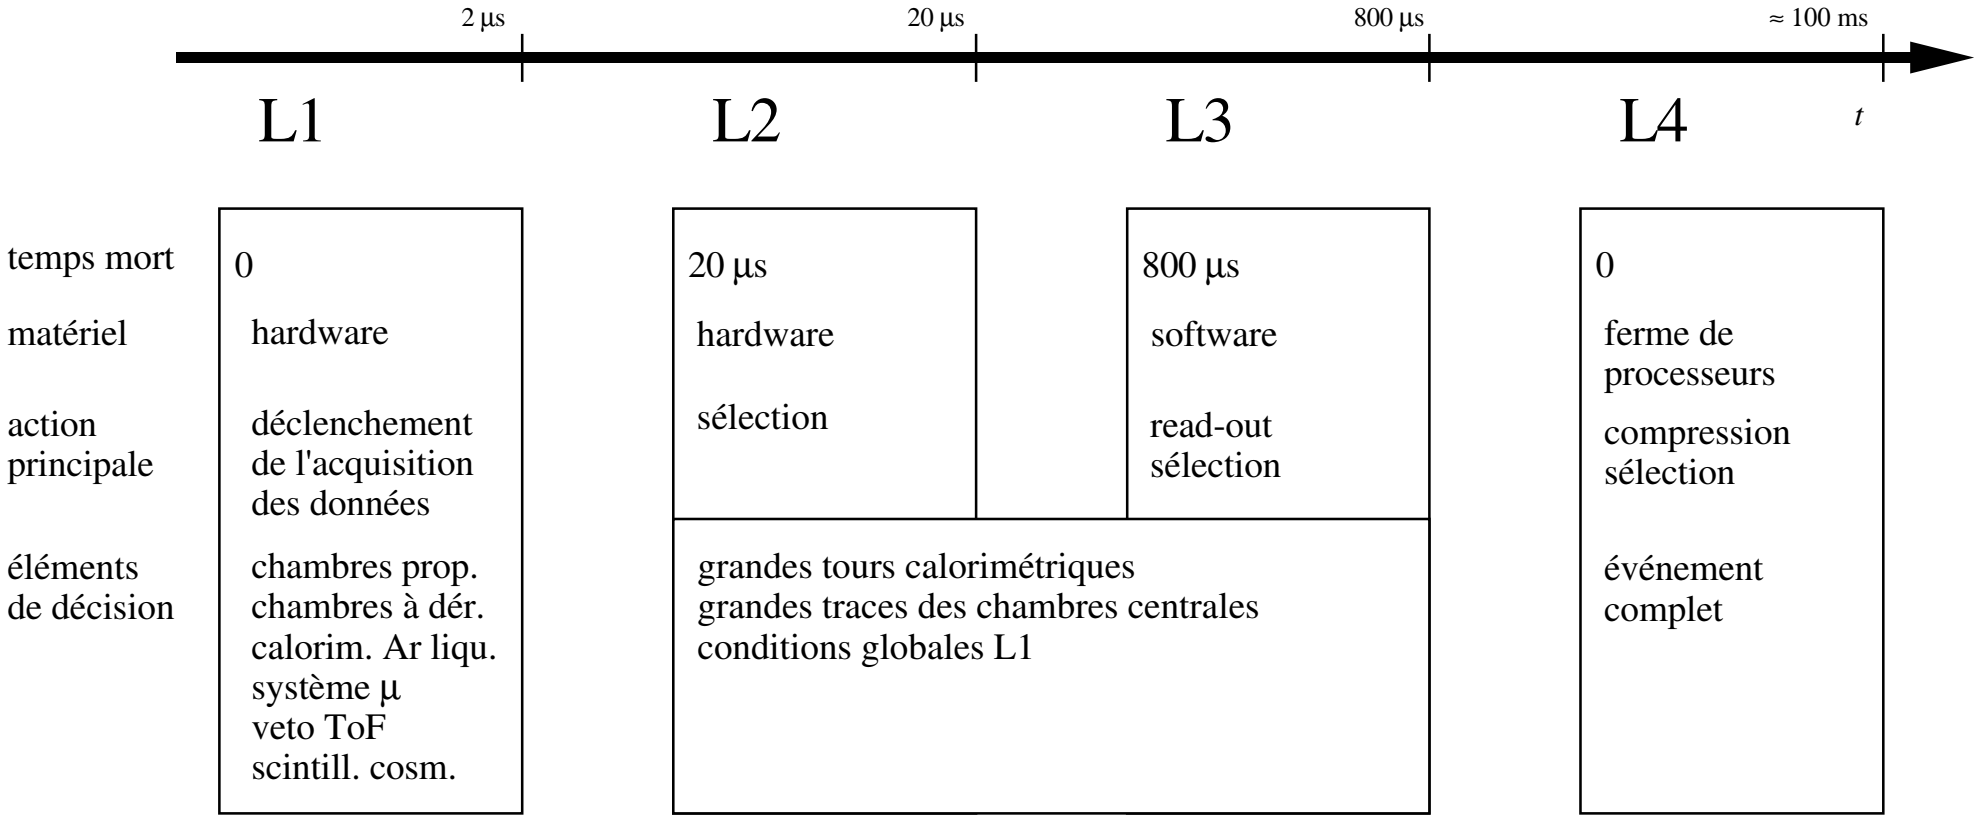
2 µs
20 µs
800 µs
≈ 100 ms
L1
L2
L3
L4
t
temps mort
matériel
action principale
éléments de décision
0
hardware
déclenchement de l'acquisition des données
chambres prop.
chambres à dér.
calorim. Ar liqu.
système µ
veto ToF
scintill. cosm.
20 µs
hardware
sélection
800 µs
software
read-out
sélection
grandes tours calorimétriques
grandes traces des chambres centrales
conditions globales L1
0
ferme de processeurs
compression
sélection
événement complet